


| NÚMERO DE REF. | Nombre del marcador                                       | Nombre del producto                                                                                | Tipo                            | Rango de medición                                       | Tipo de muestra      | Volumen de muestra a diluir | Tiempo de reacción | Calificación |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| A02084         | Malaria (Pf/Pan)                                          | Kit de prueba rápida de malaria (Pf/Pan)                                                           | Infecciones parasitarias        | Deteccion cualitativa                                   | SE                   | 5µL                         | 15 minutos         | CE           |
| A02083         | Malaria (Pf/Pv)                                           | Kit de prueba rápida de malaria (Pf/Pv)                                                            |                                 | Deteccion cualitativa                                   | SE                   | 5µL                         | 15 minutos         | CE           |
| A02085         | IgM/IgG del dengue                                        | Kit de prueba rápida de IgM/IgG para el dengue                                                     | Infecciones virales             | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 10µL/10µL/10µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02107         | Dengue NS1                                                | Kit de prueba rápida de dengue NS1                                                                 |                                 | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02034         | Ag de superficie de la hepatitis B                        | Kit de prueba rápida de HBsAg                                                                      |                                 | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         |              |
| A02169         | Anticuerpos de superficie de la hepatitis B               | Kit de prueba rápida HBsAb                                                                         |                                 | 5-1000mIU/mL                                            | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         |              |
| A02035         | Anticuerpos anti-virus de la hepatitis C                  | Kit de prueba rápida del VHC                                                                       |                                 | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         |              |
| A02091         | Anticuerpo neutralizante de COVID                         | Prueba de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 (ensayo inmunocromatográfico de fluorescencia) |                                 | 10.00 ~1000.00 IU/mL                                    | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02044         | COVID -Ag                                                 | Prueba rápida de antígeno de COVID-19                                                              |                                 | Deteccion cualitativa                                   | NP/OP                | Refer to IFU                | 15 minutos         |              |
| A02105         | Influenza A/B                                             | Kit de prueba rápida de influenza A/B                                                              |                                 | Deteccion cualitativa                                   | NP/OP                | Refer to IFU                | 15 minutos         | CE           |
| A02108         | Virus respiratorio sincitial Ag                           | Kit de prueba rápida de Ag del RSV                                                                 |                                 | Deteccion cualitativa                                   | NP/OP                | Refer to IFU                | 15 minutos         | CE           |
| A02099         | Virus de la inmunodeficiencia humana Ab                   | Kit de prueba rápida anti-VIH (1 y 2)                                                              |                                 | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         |              |
| A02165         | Ag/Ab del virus de la inmunodeficiencia humana            | Kit de prueba rápida de VIH Ag/Ab                                                                  | Infecciones bacterianas         | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         |              |
| A02115         | Treponema pallidum Ab                                     | Kit de prueba rápida anti-TP                                                                       |                                 | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02082         | Ab de Helicobacter pylori                                 | Kit de prueba rápida anti-HP                                                                       |                                 | Deteccion cualitativa                                   | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02081         | Ag de Helicobacter pylori                                 | Kit de prueba rápida HP                                                                            |                                 | Deteccion cualitativa                                   | Heces                | 100ul/50mg                  | 15 minutos         | CE           |
| A02167         | Streptococcus Grupo A                                     | Kit de prueba de Streptococcus del grupo A                                                         |                                 | Deteccion cualitativa                                   | Hisopado de garganta | Refer to IFU                | 15 minutos         | CE           |
| A02109         | Sangre oculta en heces                                    | Kit de prueba rápida FOB                                                                           |                                 | 0.05 ~ 20.00 µg/mL                                      | Heces                | 100ul/50mg                  | 15 minutos         | CE           |
| A02086         | Calprotectina                                             | Kit de prueba rápida de calprotectina                                                              | Enfermedad del tracto digestivo | 10.00 ~ 1000.00 µg/g                                    | Heces                | 100ul/50mg                  | 15 minutos         | CE           |
| A02103         | Troponina I Ultra                                         | Kit de prueba ultrarrápida de troponina I                                                          |                                 | 0.03 ~ 20.00 ng/mL                                      | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02001         | Propéptido natriurético tipo B N-terminal                 | Kit de prueba rápida de NT-proBNP                                                                  | Marcador cardíaco               | 150.00 ~ 35000.00pg/mL                                  | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02003         | Troponina cardíaca I                                      | Kit de prueba rápida de cTnI                                                                       |                                 | 0.10 ~ 50.00 ng/mL                                      | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02004         | Troponina T cardíaca                                      | Kit de prueba rápida de cTnT                                                                       |                                 | 50.00 ~ 10000.00 pg/mL                                  | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02005         | Mioglobina                                                | Kit de prueba rápida Myo                                                                           |                                 | 10.00 ~ 400.00 ng/mL                                    | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02006         | CK-MB                                                     | Kit de prueba rápida CK-MB                                                                         |                                 | 2.00 ~ 100.00 ng/mL                                     | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02010         | Supresión soluble de la tumorigenicidad 2                 | Kit de prueba rápida sST2                                                                          |                                 | 5.00 ~ 400.00ng/mL                                      | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02046         | Proteína transportadora de ácidos grasos de tipo cardíaco | Kit de prueba rápida H-FABP                                                                        |                                 | 1.00 ~ 120.00 ng/mL                                     | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02002         | CK-MB/cTnI/Mio                                            | Kit de prueba rápida CK-MB/cTnI/Myo                                                                |                                 | CK-MB: 2.00 ~100.00 ng/mL;<br>cTnI: 0.10 ~ 50.00 ng/mL; | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02008         | Dímero D                                                  | Kit de prueba rápida de dímero D                                                                   |                                 | Myo: 10.00 ~ 400.00 ng/mL<br>0.10 ~ 10.00 ng/L FEU      | P/WB                 | 50µL/50µL                   | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02016         | Proteína beta transportadora de calcio S100               | Kit de prueba rápida S100-β                                                                        | Apoplejía cerebral              | 0.08 ~ 10.00ng/mL                                       | S                    | 50µL                        | 15 minutos         | CE           |
| A02011         | proteína C reactiva                                       | Kit de prueba rápida de PCR                                                                        | Inflamación                     | 0.50 ~ 200.00 mg/L                                      | S/P/SE               | 10µL/10µL/10µL              | 3 minutos          | CE/NMPA      |
| A02012         | Procalcitonina                                            | Kit de prueba rápida de PCT                                                                        |                                 | 0.10 ~ 100.00 ng/mL                                     | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02013         | Amiloide A sérico                                         | Kit de prueba rápida de SAA                                                                        |                                 | 3.00 ~ 200.00 mg/L                                      | S/P/SE               | 10µL/10µL/10µL              | 3 minutos          | CE/NMPA      |
| A02014         | Interleucina -6                                           | Kit de prueba rápida de IL-6                                                                       |                                 | 3.00 ~ 4000.00 pg/mL                                    | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02015         | Proteína de unión a la heparina                           | Kit de prueba rápida de HTA                                                                        |                                 | 5.00~300.00ng/mL                                        | P(only EDTA)         | 50µL                        | 15 minutos         | CE/NMPA      |
| A02064         | Proteína C reactiva/Amiloides A                           | Kit de prueba rápida de PCR/SAA                                                                    |                                 | CRP: 0.50 ~ 200.00 mg/L<br>SAA: 3.00 ~ 200.00 mg/L      | S/P/SE               | 10µL/10µL/10µL              | 3 minutos          | CE           |
| A02170         | Proteína C reactiva - alta sensibilidad                   | Kit de prueba rápida de PCR-as                                                                     |                                 | 0.5-5.0 mg/L                                            | S/P/SE               | 10µL/10µL/10µL              | 3 minutos          | CE           |
| A02049         | Triyodotironina libre                                     | Kit de prueba rápida FT3                                                                           | Hormonas tiroideas              | 1.00 ~ 50.00 pmol/L                                     | S/P                  | 50µL/50µL                   | 15 minutos         | CE           |
| A02050         | Tiroxina libre                                            | Kit de prueba rápida FT4                                                                           |                                 | 1.00 ~100.00 pmol/L                                     | S/P                  | 50µL/50µL                   | 15 minutos         | CE           |
| A02022         | Triyodotironina total                                     | Kit de prueba rápida TT3                                                                           |                                 | 0.80 ~ 10.00 nmol/L                                     | S/P                  | 50µL/50µL                   | 15 minutos         | CE           |
| A02023         | Tiroxina total                                            | Kit de prueba rápida TT4                                                                           |                                 | 15.00 ~ 320.00 nmol/L                                   | S/P                  | 50µL/50µL                   | 15 minutos         | CE           |
| A02024         | Hormona estimulante de la tiroides                        | Kit de prueba rápida de TSH                                                                        | Diabetes                        | 0.10 ~100.00 mIU/L                                      | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |
| A02017         | Hemoglobina glicosilada                                   | Kit de prueba rápida de HbA1c                                                                      |                                 | 3.00% ~ 15.00%                                          | SE                   | 10µL                        | 5 minutos          | CE           |
| A02078         | Insulina                                                  | Kit de prueba rápida INS                                                                           |                                 | 0.50 ~ 500.00 µU/mL                                     | S/P/SE               | 50µL/50µL/50µL              | 15 minutos         | CE           |

|        |                                                         |                                                  |                        |                                                                                |         |                |            |         |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|---------|
| A02027 | Hormona folículo estimulante                            | Kit de prueba rápida de FSH                      | Hormonas reproductivas | 1.00 ~ 200.00 mIU/mL                                                           | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02042 | Progesterona                                            | Kit de prueba rápida PROG                        |                        | 1.00 ~ 60.00 ng/mL                                                             | S/P     | 50µL/50µL      | 15 minutos | CE      |
| A02043 | Testosterona                                            | Kit de prueba rápida TES                         |                        | 0.20 ~16.00 ng/mL                                                              | S/P     | 50µL/50µL      | 15 minutos | CE      |
| A02026 | Hormona luteinizante                                    | Kit de prueba rápida de LH                       |                        | 1.00 ~ 200.00 mIU/mL                                                           | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02028 | Prolactina                                              | Kit de prueba rápida de PRL                      |                        | 1.00 ~ 200.00 ng/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02007 | Estradiol                                               | Kit de prueba rápida E2                          |                        | 30.00 ~ 3000.00 pg/mL                                                          | S/P     | 50µL/50µL      | 15 minutos | CE      |
| A02025 | β-gonadotropina coriónica humana                        | Kit de prueba rápida de β-HCG                    |                        | 2.00 ~ 200.000.00 mIU/mL                                                       | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02041 | Hormona antimülleriana                                  | Kit de prueba rápida de AMH                      | Hormonas suprarrenales | 0.20 ~ 20.00 ng/mL                                                             | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02018 | Cortisol                                                | Kit de prueba rápida Cor                         |                        | 5.00 ~ 2000.00 nmol/L                                                          | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02032 | Antígeno carcinoembrionario                             | Kit de prueba rápida de CEA                      | Marcador de cáncer     | 1.00 ~ 500.00 ng/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02051 | CA 125                                                  | Kit de prueba rápida CA125                       |                        | 2.00 ~ 600.00 U/ml                                                             | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02052 | CA 15-3                                                 | Kit de prueba rápida CA15-3                      |                        | 3.00 ~ 300.00 U/ml                                                             | S/P/SE  | 10µL/10µL/10µL | 15 minutos | CE      |
| A02053 | CA 19-9                                                 | Kit de prueba rápida CA19-9                      |                        | 2.00 ~ 700.00 U/ml                                                             | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02048 | Alfa-fetoproteína                                       | Kit de prueba rápida de AFP                      |                        | 5.00 ~ 500.00 ng/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02130 | Pepsinógeno I                                           | Kit de prueba rápida PGI                         |                        | 2.00 ~ 200.00 ng/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02131 | Pepsinógeno II                                          | Kit de prueba rápida PGII                        |                        | 1.00 ~ 100.00 ng/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02020 | Gastrin-17                                              | Kit de prueba rápida G-17                        |                        | 1.00 ~ 40.00 pmol/L                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE/NMPA |
| A02021 | Pepsinógeno I/II                                        | Kit de prueba rápida PGI/PGII                    |                        | PGI: 2.00 ~ 200.00 ng/mL;<br>PGII: 1.00 ~ 100.00 ng/mL                         | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE/NMPA |
| A02030 | Antígeno prostático específico                          | Kit de prueba de PSA                             |                        | 0.10 ~ 100.00 ng/ml                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos |         |
| A02031 | antígeno prostático específico libre                    | Kit de prueba de fPSA                            | Función inmunológica   | 0.1 ~ 60.00 ng/ml                                                              | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos |         |
| A02033 | Inmunoglobulina E                                       | Kit de prueba rápida de IgE                      |                        | 1.00 ~1000.00 IU/mL                                                            | S/P/SE  | 10µL/10µL/10µL | 15 minutos | CE      |
| A02065 | Anticuerpo Antipéptido Citrulinado Ciclico              | Kit de prueba rápida anti-PCCh                   | Artritis reumatoide    | 10.00 ~ 500.00 U/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02089 | Factor reumatoide                                       | Kit de prueba rápida de RF                       |                        | 10.00 ~ 160.00 IU/mL                                                           | S/P/SE  | 10µL/10µL/10µL | 5 minutos  | CE      |
| A02166 | Anti-estreptolisina O                                   | Kit de prueba rápida ASO                         |                        | 20.00 ~ 500.00 IU/mL                                                           | S/P/SE  | 10µL/10µL/10µL | 5 minutos  | CE      |
| A02088 | Factor de crecimiento similar a la insulina 1           | Kit de prueba rápida de IGF-1                    | Factor de crecimiento  | 15.00 ~ 1000.00 ng/mL                                                          | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02019 | 25-hidroxit vitamina D                                  | Kit de prueba rápida de 25-(OH) VD               | Metabolismo óseo       | 10.00 ~100.00ng/mL                                                             | S/P/SE  | 10µL/10µL/10µL | 15 minutos | CE/NMPA |
| A02047 | lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos      | Kit de prueba rápida NGAL                        | Función renal          | 10.00 ~ 1500.00 ng/mL                                                          | Orina   | 50µL           | 15 minutos | CE      |
| A02040 | Microalbuminuria                                        | Kit de prueba rápida MAU                         |                        | 5.00 ~ 200.00 mg/L                                                             | Orina   | 50µL           | 15 minutos | CE      |
| A02029 | Ferritina                                               | Kit de prueba rápida de ferritina                | Anemia                 | 2.00 ~1000.00 ng/mL                                                            | S/P/SE  | 50µL/50µL/50µL | 15 minutos | CE      |
| A02079 | Vitamina B12                                            | Kit de prueba rápida VB12                        |                        | 100.00 ~ 2000.00 pg/mL                                                         | S/P     | 50µL/50µL      | 10 minutos | CE      |
| A02080 | Folato                                                  | Kit de prueba rápida de folato                   |                        | 1.00 ~ 30.0 ng/mL                                                              | S       | 10µL           | 15 minutos | CE      |
| A02054 | Tetrahydrocannabinol                                    | Kit de prueba rápida de THC                      | Cabello DOA            | 0.02 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02055 | Cafeína                                                 | Kit de prueba rápida CAF                         |                        | 1.00 ~ 50.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02056 | Metcatinona                                             | Kit de prueba rápida MCAT                        |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02057 | Tramadol                                                | Kit de prueba rápida TRA                         |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02058 | 3,4-Methylenedioxymethamphetamine                       | Kit de prueba rápida de MDMA                     |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02061 | cannabinoides sintéticos                                | Kit de prueba rápida de cannabinoides sintéticos |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02106 | Cocaína                                                 | Kit de prueba rápida de COC                      |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02036 | Metanfetamina                                           | Kit de prueba rápida MET                         |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02037 | Morfina                                                 | Kit de prueba rápida MOP                         |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02038 | Ketamina                                                | Kit de prueba rápida KET                         |                        | 0.10 ~ 10.00 ng/mg                                                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02059 | Metanfetamina/Morfina                                   | Kit de prueba rápida de abuso de drogas          |                        | MET: 0.10 ~ 10.00 ng/mg<br>MOP: 0.10 ~ 10.00 ng/mg                             | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02039 | Metanfetamina/Morfina/Ketamina                          | Kit de prueba rápida de abuso de drogas          |                        | MET: 0.10 ~ 10.00 ng/mg<br>MOP: 0.10 ~ 10.00 ng/mg<br>KET: 0.10 ~ 10.00 ng/mg  | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02073 | Methamphetamine/Tetrahydrocannabinol                    | Kit de prueba rápida de MET/THC                  |                        | MET 0.1-10.0 ng/mg;<br>THC 0.02-10.0 ng/mg;                                    | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02077 | Cocaína/Metilendioximetanfetamina/ Tetrahydrocannabinol | Kit de prueba rápida de abuso de drogas          |                        | COC: 0.10 ~ 10.00 ng/mg<br>MDMA: 0.10 ~ 10.00 ng/mg<br>THC: 0.02 ~ 10.00 ng/mg | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |
| A02168 | Etomidato                                               | Kit de prueba rápida de etomidato                |                        | 0.1-10.0 ng/mg                                                                 | Cabello | 5-8mg          | 5 minutos  | CE      |

# Inmunoensayo de fluorescencia


## Analizador AF-100

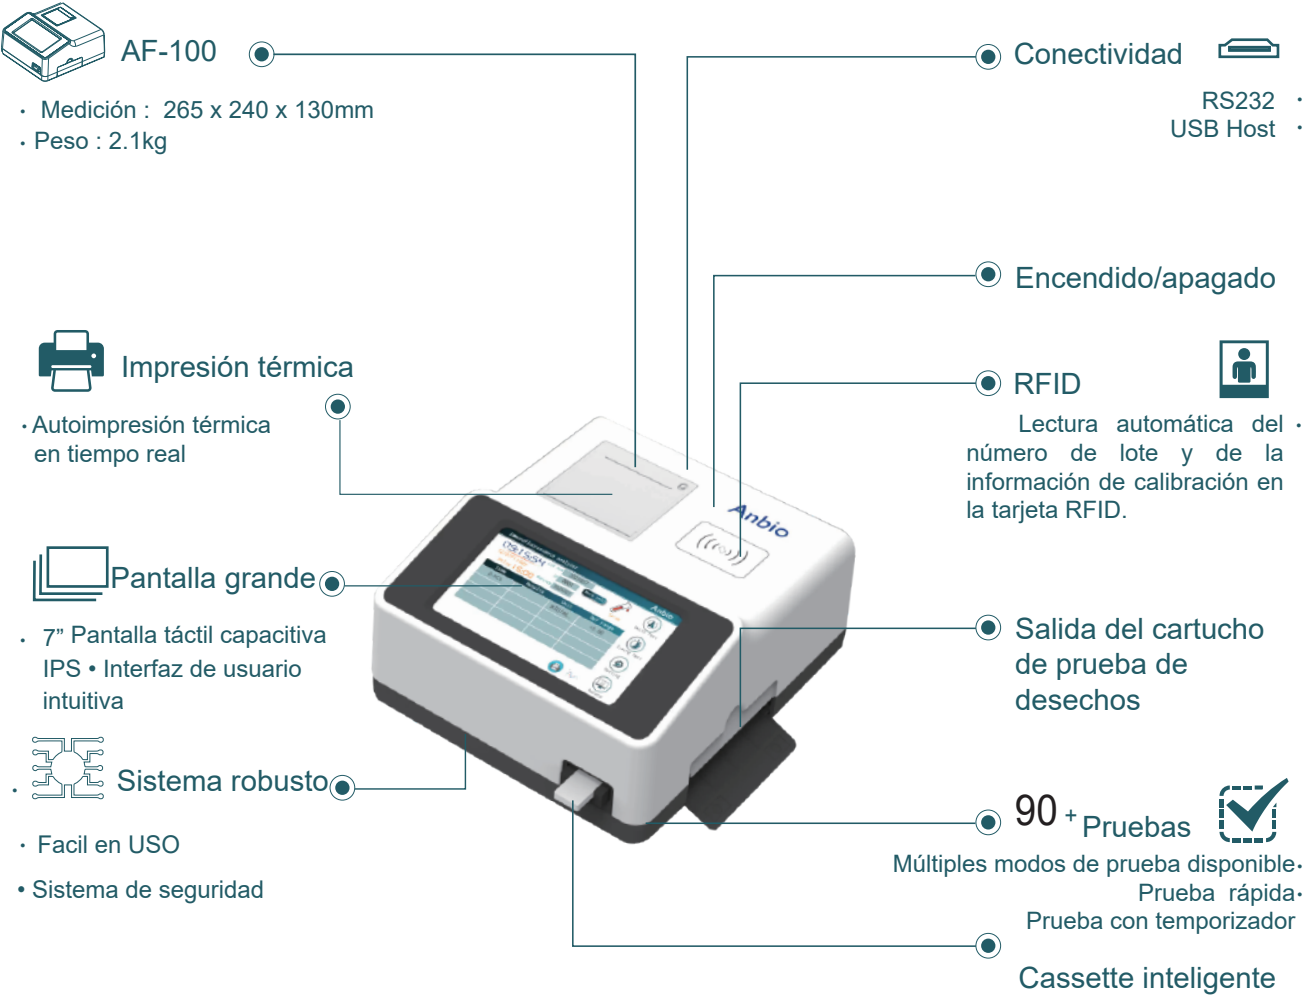

**Pruebas**  
Apto para sangre completa, suero, plasma y orina.  
Almacenamiento a temperatura ambiente.  
Resultados en 3-15 minutos.



## Procedimiento de operación

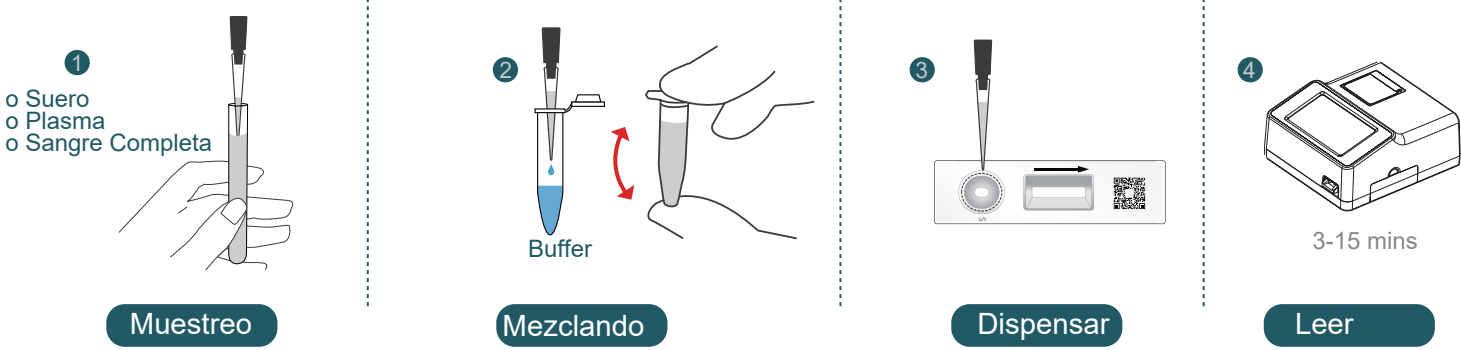

# Anbio

## Inmunoensayo de fluorescencia

### Analizador AF-100

**Ventajas:** Dispositivo pequeño, gran impacto: 1 canal, múltiples pruebas a la vez



- Portátil**  
Un dispositivo médico del tamaño de una palma
- Resultados instantáneos**  
Resultados precisos en tan solo 3 minutos
- Fácil de usar**  
Con una pantalla táctil fácil de usar y una interfaz intuitiva, el procedimiento de prueba se simplifica.
- Preciso**  
Muestra una fuerte correlación con los métodos de referencia de laboratorio.

## Escenarios de aplicación



**CONTACT US**  
For more information, please visit [www.anbio.com/contact](http://www.anbio.com/contact) or explore further details at [www.anbio.com](http://www.anbio.com)  
INT-FIA-AF100-202505-01 ©2025 Anbio Biotechnology. All rights reserved.



Subscribe us on LinkedIn for latest insights and news of Anbio Biotechnology